

实验室压力表 DN 100/150 等级 0,25%

概述

该压力表设计用于控制、校准及其他应用领域的精密和可重复性操作。如果有要求，我们能够提供LAT认证证书。




安德鲁信重工江苏有限公司


地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

单位：毫米


DN 100/150

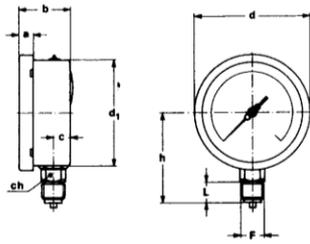


TYPE A

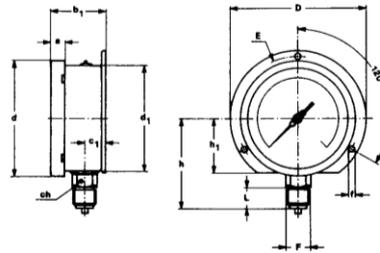


TYPE C

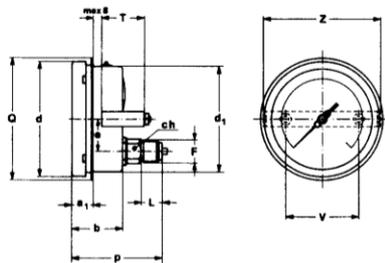

TYPE B

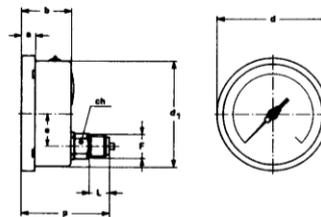

TYPE D

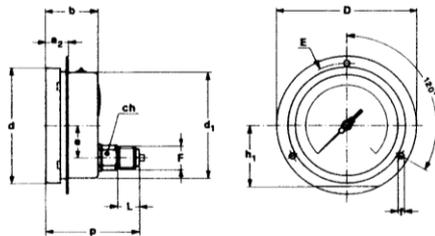

TYPE E

DN	TYPE	F	L	A	A1	b	b1	d	d1	D	E	M	ch
100	AC	1/2	20	13	-	48,5	52,6	110,6	101	130	118	-	22
100	DBE	1/2	20	13	20	48,5	-	109,8	101	130	118	85,5	22

DN	TYPE	F	L	A	A1	b	b1	d	d1	D	E	M	ch
150	AC	1/2	20	15	-	50,5	54	161	150	190	175	-	22
150	DBE	1/2	20	15	25,5	50,5	-	161	150	190	175	87,5	22



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980

网址：www.andrewen.com

www.andrewen.net

邮箱：info@andrewen

技术参数

适用标准: EN 837-1

公称尺寸(mm) : 100 mm, 150 mm

范围: 压力从 -1 bar 至 1000 bar

精度: 0,25%

环境温度: +20°C (操作)

工艺温度: 最大 100°C

工作压力: 不适用

保护等级: 适用于IEC 529标准的 IP 67

表壳: AISI 304 L st.st.

密封圈: AISI 304 st.st., 卡锁

刻度盘: 白色铝质, 黑色标记和反视差带

指针: 黑色铝质, 可用刀片调微

表玻璃: 钢化玻璃, 厚度4毫米

表玻璃垫: EPDM

弹簧管: AISI 316L

动作: 不锈钢

支架: AISI 316L st.st.

Welding : AISI 316 TIG Argonac

温度漂移: $\pm 0,4\%$ / 10°C of FVS (以20°C为基准温度)



安德鲁信重工江苏有限公司

地址: 江苏省江阴市澄江东路3号 电话: 0510-86199978 86199979 传真: 0510-86199980
网址: www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱: info@andrewen